NL Mobiele UV-spot

OPGEPAST -

Gebruiksaanwijzing in acht nemen!

Het installeren van toebehoren evenals het achteraf uitrusten van toestelcomponenten mag alleen maar in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing uitgevoerd worden.

De mobiele UV-spot is in twee uitrustingsvarianten leverbaar:

- Vast toestel **Spot 30**, bestaat uit het lamplichaam [3], twee afneembare framevoeten [10] (voor KS 9 bijkomend 2 houdhoeken voor hangend gebruik), de stralerbescherming [4] en de aansluitkabel met koudtoestelstekker [8] en UV-stekker [9].
- Hanginrichting **Spot K**, bestaat uit het lamplichaam [14], de stralerbescherming [13] met de aansluitkabel UV-stekker [11]. Om de hanginrichting te gebruiken is de ophanginrichting als bijkomend toebehoren noodzakelijk. (KS 9 - Id. nr.: 50073943 / KS 12 - KS 18 - Id. nr.: 50073944)

Montage en inbedrijfstelling:

1. De stralerbescherming [4] is met telkens een kartelschroef aan het lamplichaam [3] bevestigd. De kartelschroeven volledig uitdraaien en de stralerbescherming verwijderen.
2. Installatie van de toestellen:
   - Aan het vaste toestel (**Spot 30**) de twee framevoeten [10] links en rechts met de kartelschroeven aan het lamplichaam vastschroeven. Het vaste toestel centrisch in de nuttige ruimte plaatsen. De koudtoestelstekker [8] in de contactdoos [7] aan het lamplichaam steken. De UV-stekker [9] aan één van de twee interne UV-adapters aansluiten.
     Voor het toesteltype KS 9 bestaat de mogelijkheid om de UV-straler gecombineerd met een ophanginrichting te gebruiken. Daartoe worden i.p.v. de framevoeten de houdhoeken [6] aangeschroefd.
   - De hanginrichting (**Spot K**) met de twee haken [2] aan de ophanginrichting [1] bevestigen. De UV-stekker [11] aan één van de twee interne UV-adapters aansluiten.

AANWIJZING - UV-straling

Voor de mobiele UV-spot aangesloten en geactiveerd wordt, moeten alle hulpmiddelen en monsters uit de nuttige ruimte verwijderd worden.

OPGEPAST - Gevaar van brandwonden!

De UV-straler bereikt tijdens de desinfectie zeer hoge temperaturen.
Voor de mobiele UV-spot weer gedemonteerd wordt, het lamplichaam voldoende laten afkoelen!

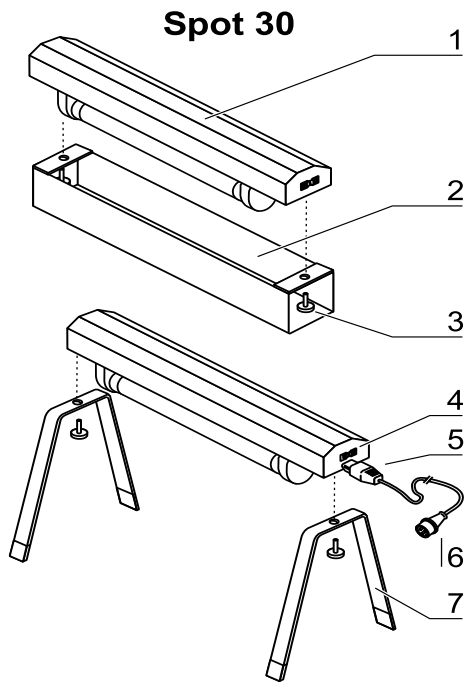

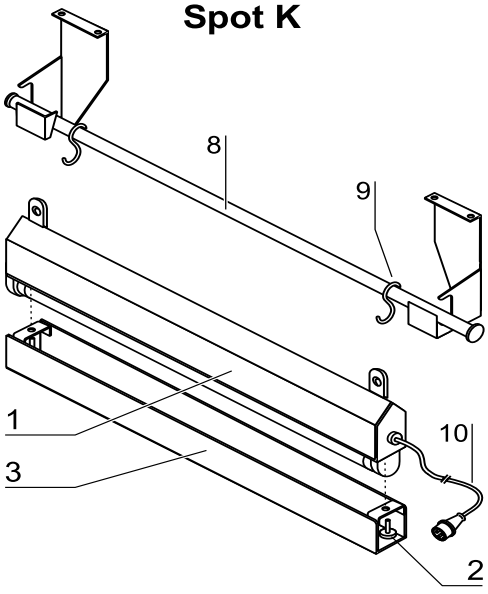

NL Mobiele UV-spot

3. Buitenbedrijfstelling:
   Aansluitkabel aftrekken, aan het vaste toestel de framevoeten afschroeven. De stralerbescherming met de kartelschroeven aan het lamplichaam schroeven.

Reserveonderdelen

Benaming	Bestelnr.:			
	SPOT 30		SPOT K	
	120 V	230 V	120 V	230 V
Doorsteekfitting	50043771	50043771	50043771	50043771
Voorschakeltoestel UV zijdelings 2 x 18 W 230 V		50048679		
Voorschakeltoestel UV zijdelings 2 x 15 W 120 V	50060299			
Voorschakeltoestel UVC straler 230 V				50048679
Voorschakeltoestel UVC straler 120 V			50060299	
UVC desinfectiestraler 15 W 435 mm lg		50048537		50048537
UVC desinfectiestraler 15 W 435 mm lg, 1	50060298		50060298	
Leiding met bus	50048531	50048531	50048531	50048531
Montagevoet	50048676	50048676	50048676	50048676
Kartelschroef	50049781	50049781	50049781	50049781
Gebruiksaanwijzing	50077503	50077503	50077503	50077503

Technische gegevens

Descripción	Eenheid	SPOT 30		SPOT K	
Breedte	mm	80		60	
Hoogte	mm	115		170	
Hoogte met montagevoet	mm	310		365	
Lengte	mm	520		995	
Gewicht	kg	2		4,5	
Elektrische gegevens					
Bemeten spanning	Volt	120	230	120	230
Bemeten frequentie	Hz	60	50	60	50
Golflengte	nm	254	254	245	245